

# **EM-80: Generator**


## **Einstellungen für alle Messungen:**

Intervall: 100 $\mu$ sec


Automatische Aufnahme

Start durch Trigger (z.B. 1V)


# Zweipolrotor, Abgriff über Schleifring

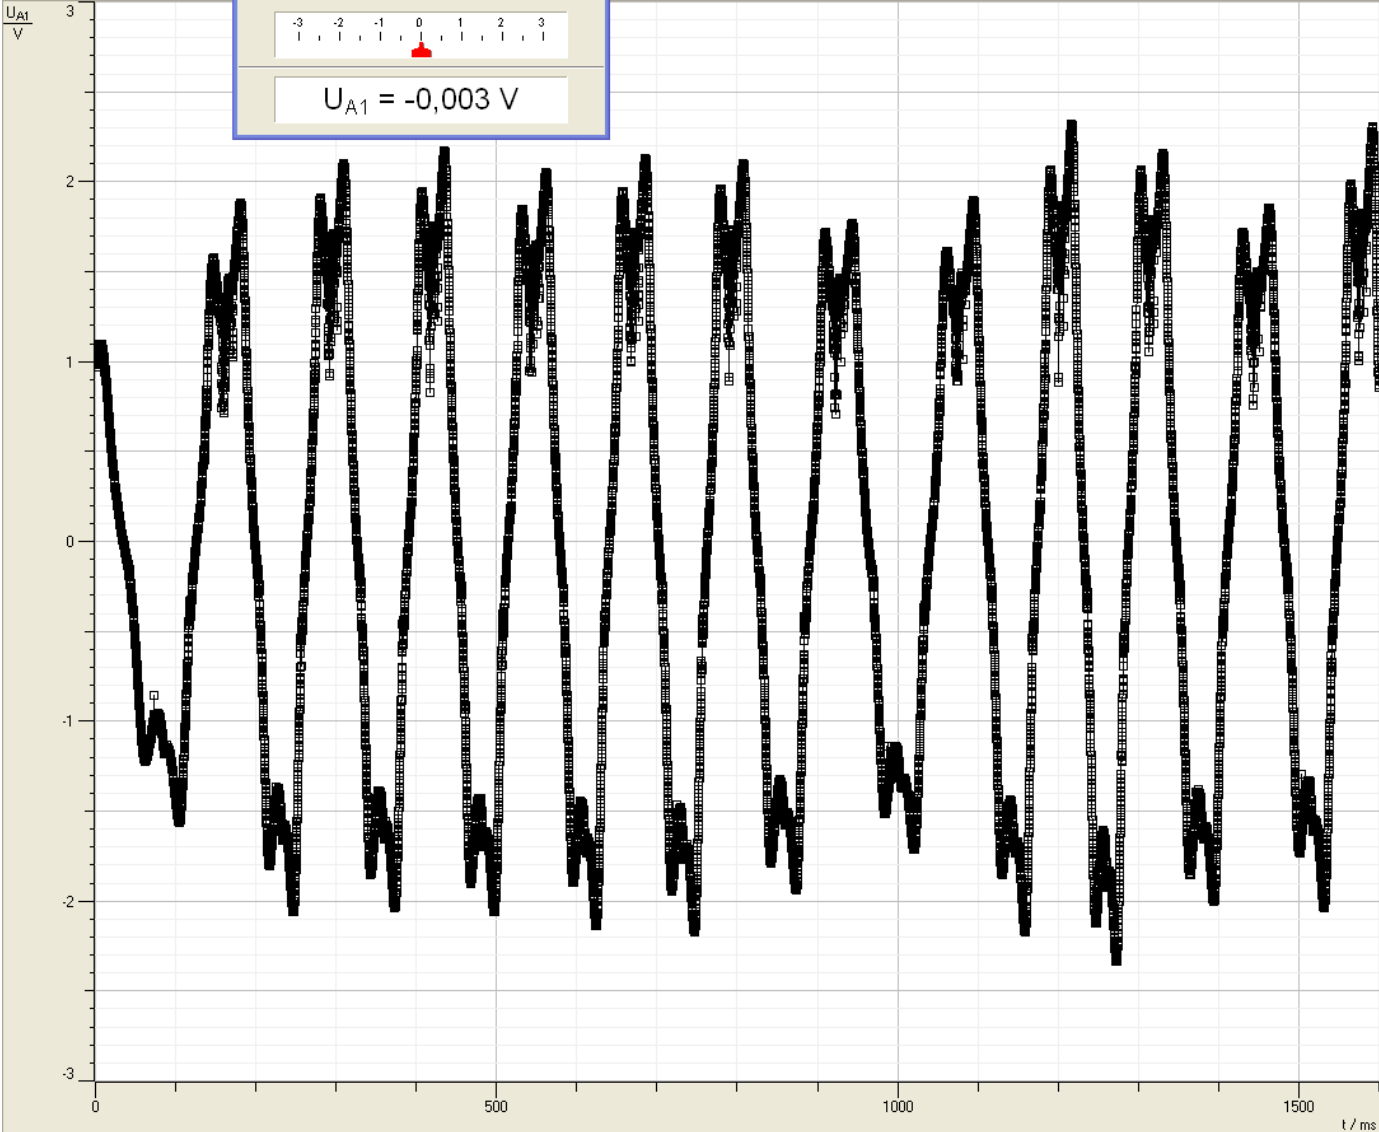

# Zweipolrotor, Abgriff über Kommutator

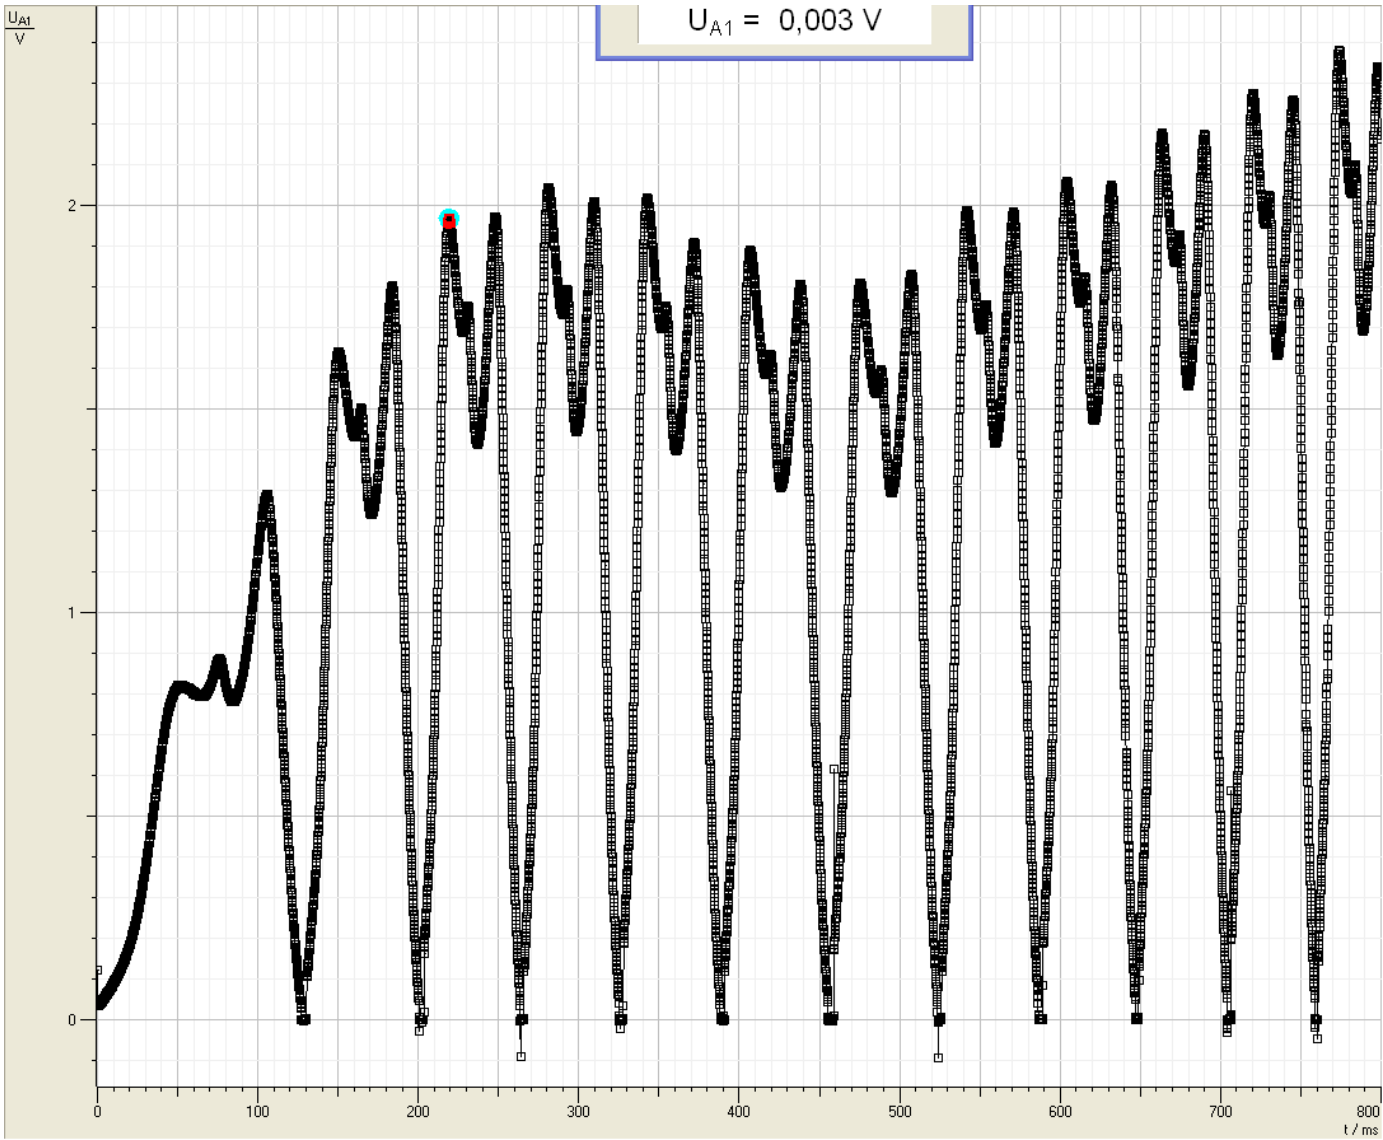

# Multipolrotor, Abgriff über Schleifring

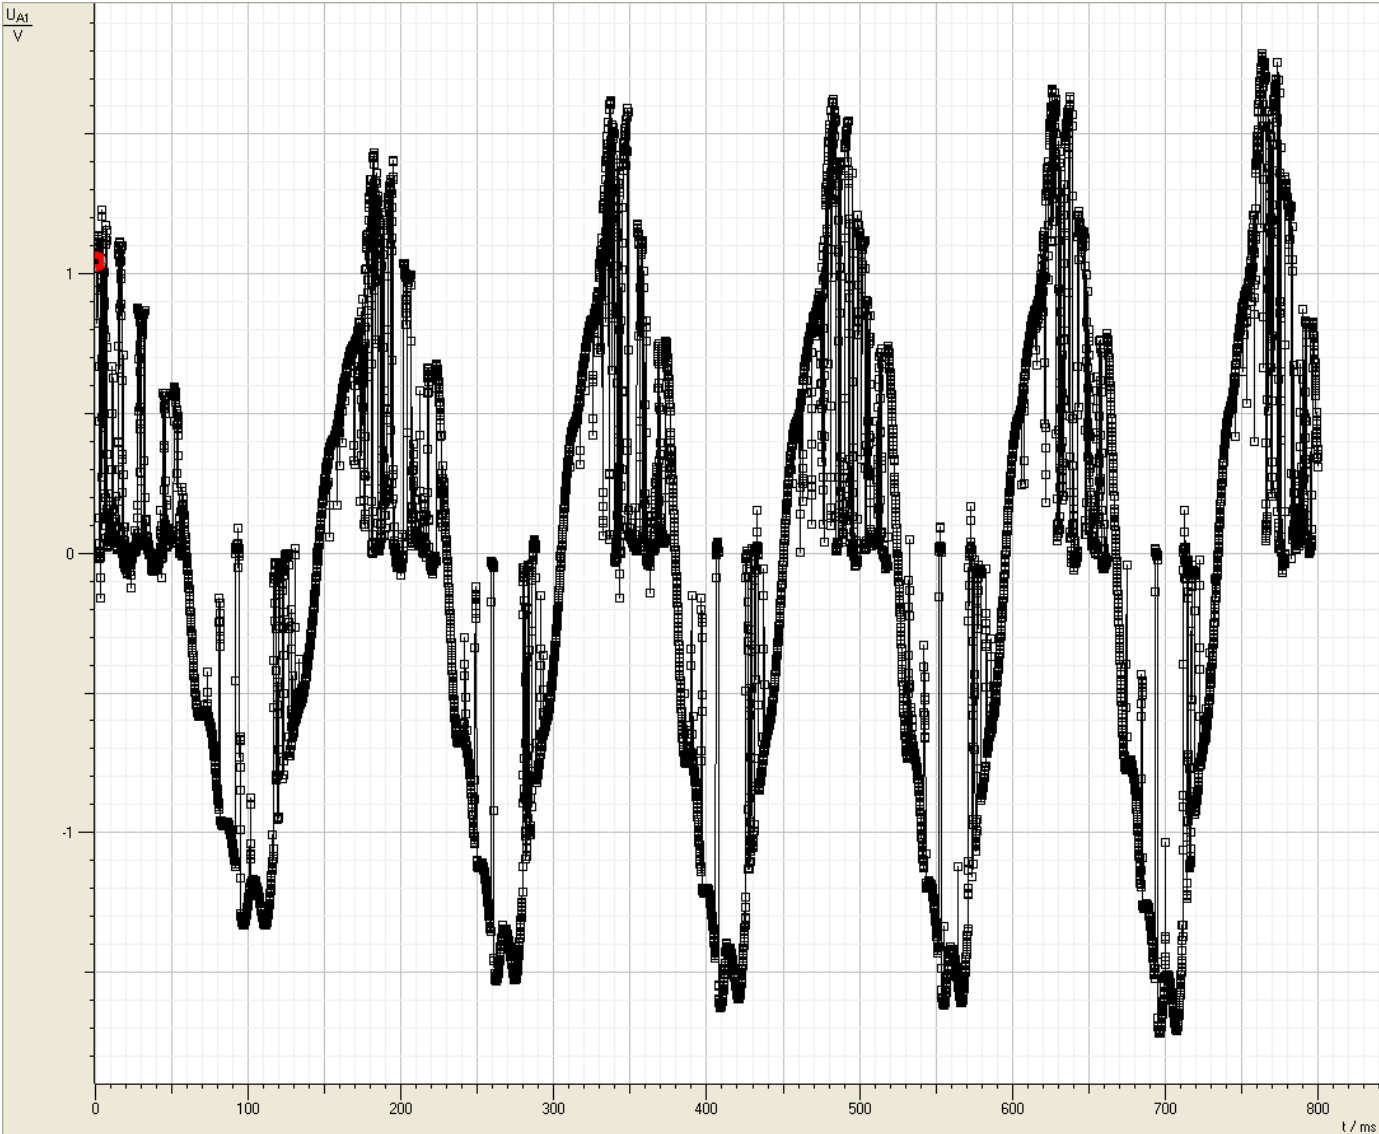

# Multipolrotor, Abgriff über Kommutator

