Fe-05: Laue-Aufnahmen von NaCl

Konfiguration des Röntgengeräts für alle Messungen:

- Molybdänröhre
- Schlitzkollimator
- Lochblende
- U = 35kV
- I = 1mA

Einstellungen der Pixeldetektor-Auslese für alle Messungen:

- Counter oder Spectrometer mode
- 1s Exposure time
- 300 Frames
- Finite count of steps
- Integral mode

Counter mode

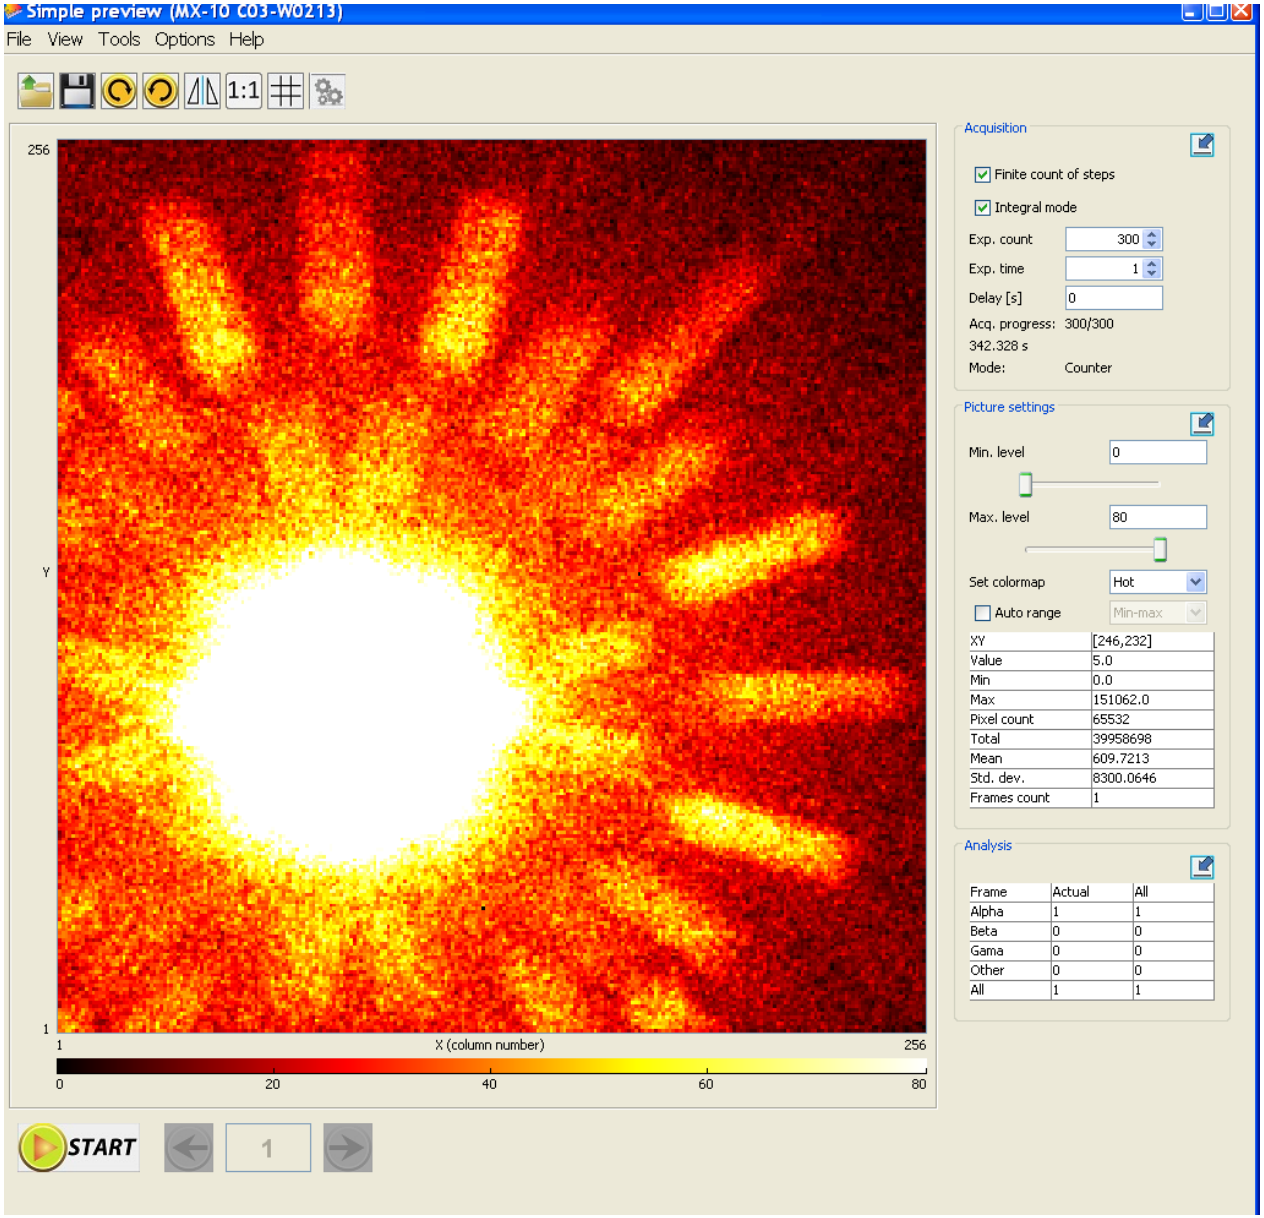
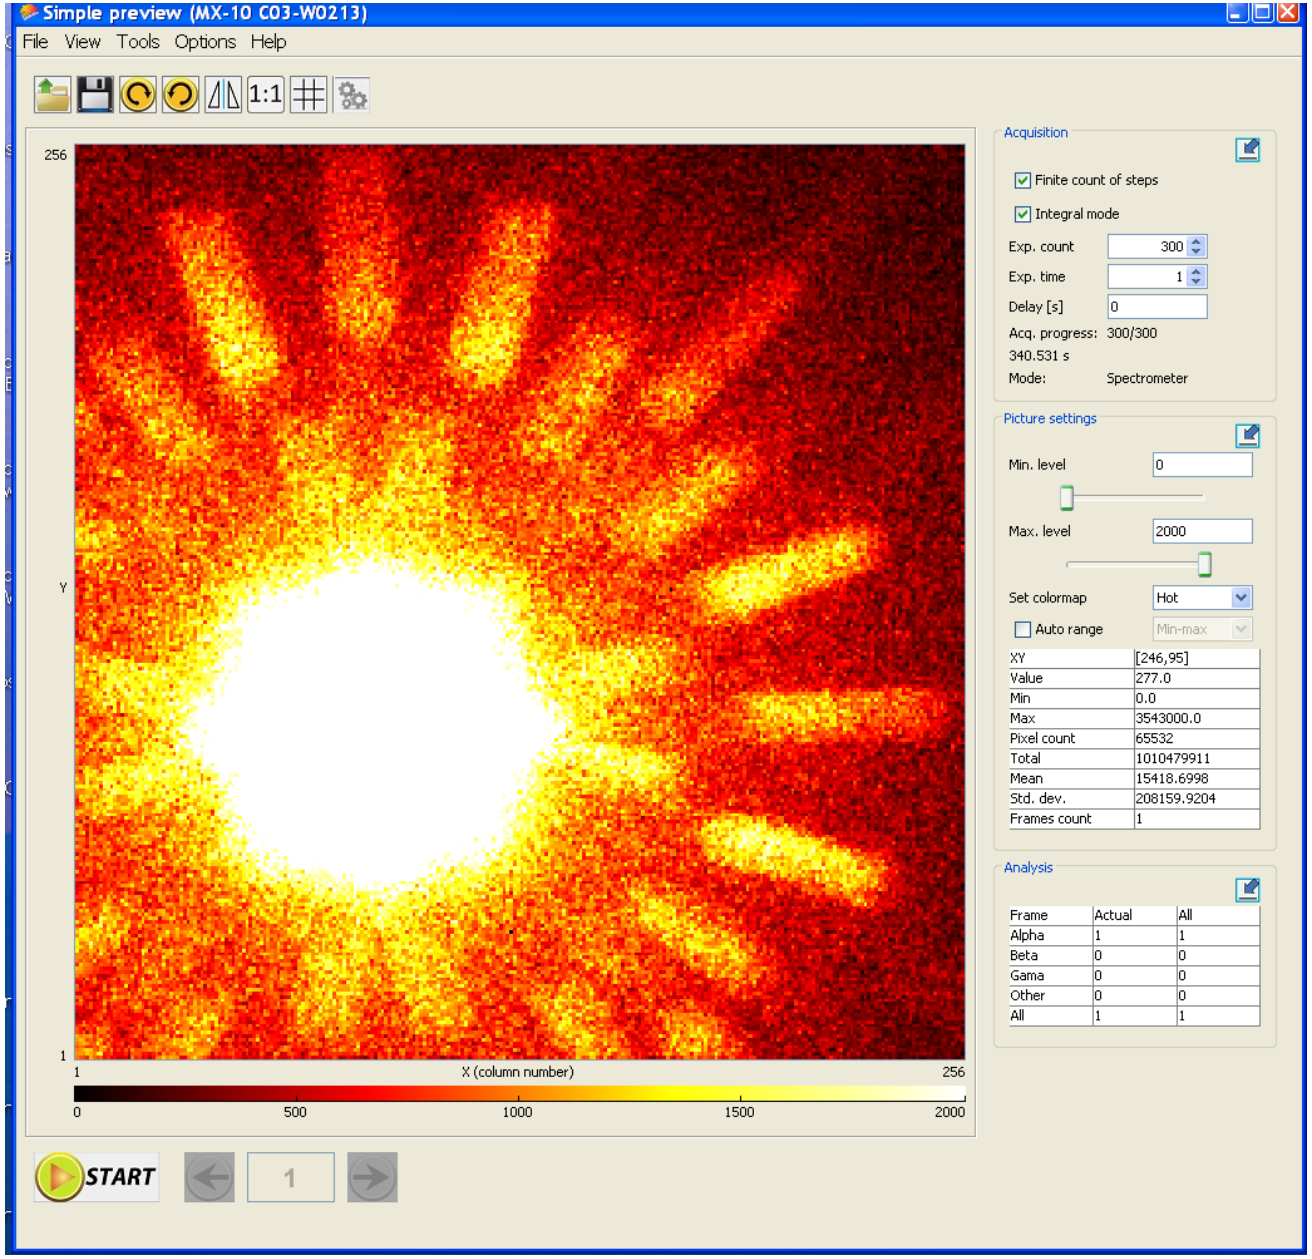
Spectrometer mode