


Kalibration des USB-Kompakt-Spektrometers


Datei ist abgespeichert als

C:\Programme\LD Didactic\SpectraLab\Kalibration


Untergrundspektrum

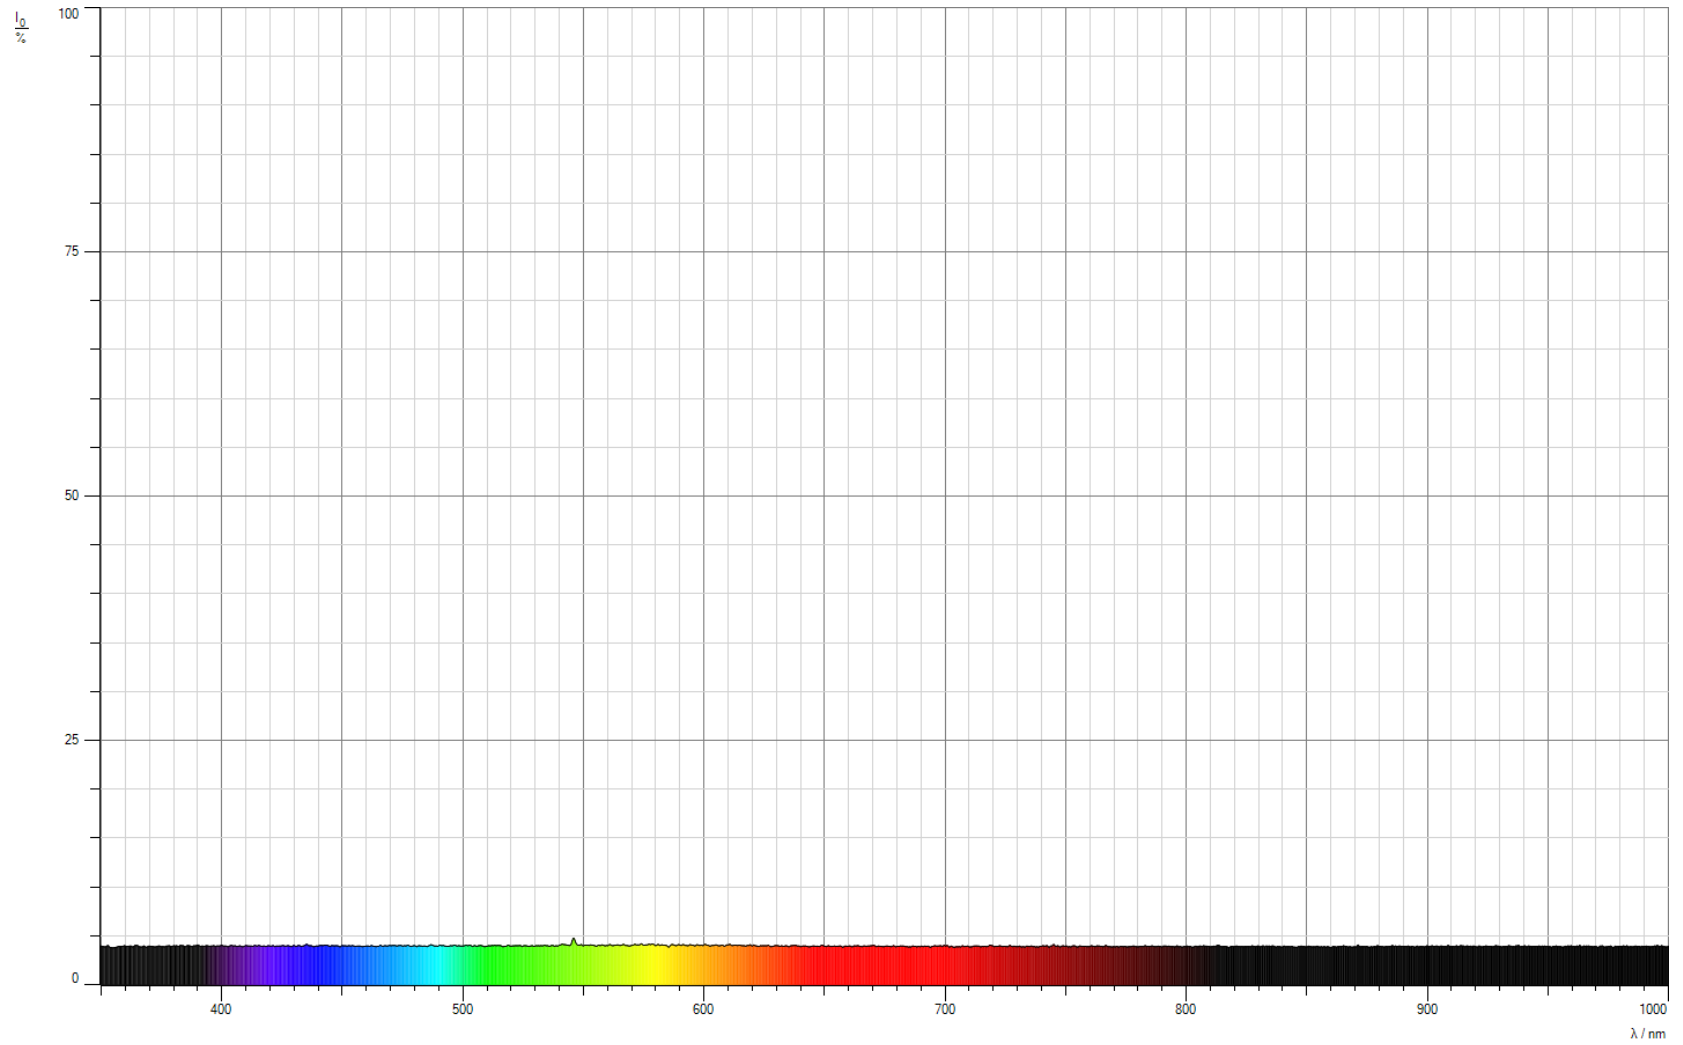


Spektrum einer 60W-Glühlampe, nach Abzug des Untergrunds



Spektrometerempfindlichkeit, bestimmt mit einem thermischen Strahler mit einer Farbtemperatur von 2680K (60W-Glühlampe)



Spektrum einer 60W-Glühlampe; in grau Spektrometerempfindlichkeit (A.U.)



Spektrum einer 60W-Glühlampe (Relative Intensität) nach Kalibration

